

## Oxidized glutathione (GSSG) content Kit

### 氧化型谷胱甘肽 (GSSG) 含量测定试剂盒说明书

货号: G0207W48 | 方法: 微板法 | 规格: 48 样

#### 一、产品简介:

谷胱甘肽通常以还原型状态(GSH) 存在, 但是GSH在氧化应激的作用下会转化为氧化型状态(GSSG)。因此GSH/GSSG的比值被认为是氧化应激研究的一个重要指标。

本试剂盒含有 GSH 掩蔽剂, 加入掩蔽剂可以除去样品溶液中的 GSH, 并在谷胱甘肽还原酶作用下使氧化型谷胱甘肽 (GSSG) 转化为还原型谷胱甘肽 (GSH), 进而与 DTNB 与反应生成在 412nm 处有特征吸收峰的复合物; 进而对 GSSG 进行定量。

#### 二、试剂盒组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
提取液	液体 50mL×1 瓶	4°C保存	
试剂一	液体 $\mu$ L×1 支	4°C保存	临用前取 60 $\mu$ L 的试剂一至一支新的 EP 管中, 加 1mL 的乙醇混匀后测定。
试剂二	EP 管×2 支	-20°C保存	用前甩几下或 4°C离心使试剂落入试管底部, 每支加 0.4mL 蒸馏水溶解备用。用不完的试剂分装后-20°C保存, 禁止反复冻融, 一星期内用完。
试剂三	液体 0.5mL×1 支	4°C保存	若凝固, 可在 25°C水浴温育片刻至全部融解后使用。
试剂四	液体 8mL×1 瓶	4°C保存	
试剂五	液体 5 $\mu$ L×1 支	-20°C保存	用前甩几下或 4°C离心使试剂落入底部, 再加 0.55mL 蒸馏水溶解备用。
标准品	粉体 mg×1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

#### 三、所需的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、低温离心机、水浴锅、可调节移液器、蒸馏水。

#### 四、氧化型谷胱甘肽 (GSSG) 含量的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

##### 1、样本制备:

① 组织样本: 称取约 0.1g 组织, 加入 1mL 提取液, 进行冰浴匀浆。4°C×12000rpm 离心 15min, 取上清液, 置冰上待测。

【注】:根据研究需求, 可按组织质量 (g): 提取液体积(mL)为 1: 10 的比例进行提取。

② 细菌/细胞样本: 先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液; 超声波破碎细菌或细胞 (功率 300w, 超声 3 秒, 间隔 7 秒, 总时间 3min); 4°C×12000rpm 离心 15min, 取上清液, 置冰上待测。

【注】:若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量 ( $10^4$  个): 提取液体积(mL)为 500~1000: 1 的比例提取

③ 液体样本: 直接检测。若浑浊, 离心后取上清检测。

##### 2、上机检测:

① 酶标仪预热 30min, 调节波长到 412nm, 所有试剂在使用前需在 25°C水浴中保温 10min。


- ② 加入试剂一时，请务必全部加入到样本液体中；若批量测定则试剂二和三和四可按照 10:10:140 配成混合液，按照 160 $\mu$ L 加样量操作。
- ③ 在 96 孔板中依次加入：

试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管
样本	20
试剂一	10
轻轻混匀，孵育 10 分钟	
试剂二	10
试剂三	10
试剂四	140
试剂五	10
混匀，室温 (25 $^{\circ}$ C) 下，立即于 412nm 读取吸光值 A1，25min 后读取吸光值 A2， $\Delta A = A2 - A1$ 。	

注意：本操作流程适用于绝大多数常规样本检测，实验条件可根据实际样本状态适度微调；针对特殊类型样本，我司技术支持可提供专属优化建议。

## 五、结果计算：

1、标准曲线方程为  $y = 4.8646x - 0.0141$ ；x 为标准品质量 (nmol)，y 为  $\Delta A$ 。

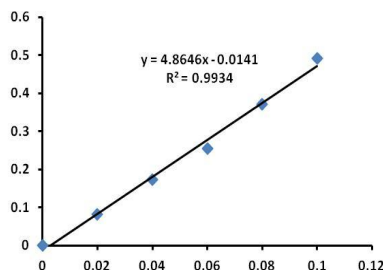

标准曲线示意图

说明：标准曲线由标准品测定获得，具体制作方法详见随货说明书或咨询技术支持。

2、按样本鲜重计算：

$$\text{GSSG}(\text{nmol/g 鲜重}) = (\Delta A + 0.0141) \div 4.8646 \div (W \times V1 \div V) = 10.28 \times (\Delta A + 0.0141) \div W$$

3、按细胞数量计算：

$$\begin{aligned} \text{GSSG}(\text{nmol}/10^4 \text{ cell}) &= (\Delta A + 0.0141) \div 4.8646 \div (\text{细胞数量} \times V1 \div V) \\ &= 10.28 \times (\Delta A + 0.0141) \div \text{细胞数量} \end{aligned}$$

4、按照液体体积计算：

$$\text{GSSG}(\text{nmol/mL}) = (\Delta A + 0.0141) \div 4.8646 \div V1 = 10.28 \times (\Delta A + 0.0141) \div V1$$

V---加入提取液体积，1mL；

V1---反应中加入样本体积，20 $\mu$ L=0.02mL；

W---样品质量，g；

## 六、注意事项：

- 粗提液不能用于测定可溶性蛋白含量。
- 一些还原剂如抗坏血酸，巯基乙醇，二硫苏糖醇 (D TT) 和半胱氨酸，或巯基反应性化合物如马来酰亚胺化合物会干扰谷胱甘肽测定。因此在样品制备过程中应避免使用这些物质。